


## Dokunmatik Ekranla Kolay Kullanım

5,7 inç VGA, 640x480. QWERTY dokunmatik klavye.  
Kullanıcının tercihine göre temel mod / ileri mod seçenekleri mevcuttur.



**300+**  
KULLANICI  
REFERANSI

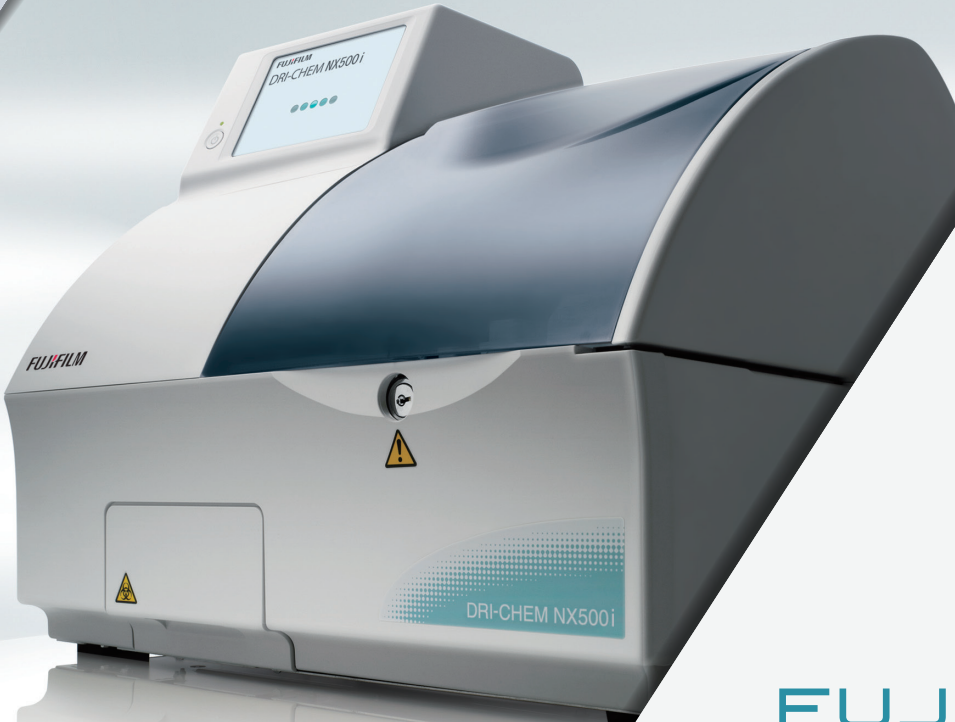

# FUJI DRI-CHEM NX500i

## Otomatik Biyokimya, C-CRP ve Elektrolit Analiz Cihazı

Fujifilm'in FUJI DRI-CHEM NX500i cihazı çoklu klinik biyokimya testleri yapabilen bir biyokimya analiz cihazıdır. Kendi içerisinde otomatik pipetleme sistemi mevcuttur, slaytlardaki reaktiflerin hazırlanmasında; kalibrasyona veya suya ihtiyaç duymaz ve bakımı kolaydır.

Yeni FUJI DRI-CHEM NX500i ile üç kolay adımda sonuçları elde edebilirsiniz. Hızlı, kolay kullanımı ve küçük tasarımı ile "gerçek zamanlı ve sınırsız" klinik biyokimya uygulamalarını mümkün kılar.

Çoklu Test Parametreleri  
Güvenilir Sonuç

FUJIFILM



DRI-CHEM NX500i



■ Kalibrasyon gerektirmeyen QC kart sistem

Manyetik kart olarak bilinenin QC kart sistemi sayesinde kalibrasyon işlemlerinizi çok daha hızlı bir şekilde yapılı.



■ Sadece 10µl numune

Her test için sadece 10 uL'lik bir örnek yeterlidir. ISE (Na, K, Cl) için ise 50 uL/3 test gerekmektedir. Cihazın manuel mod özelliği de bulunmaktadır.



■ Otomatik dilatasyon

Epey zaman harcayan bir süreç olan dilüsyon bile FUJİ DRI-CHEM'de otomatik olarak yapılmaktadır. Sadece dilüsyon oranını ayarlayın ve START'a basın. Dilüsyon testi diğer testlerle paralel olarak, bir test ayrımı gereksizdir yapılabilir.







Colorimetry

Electrolytes

26 test

3 test

128 test / saat



hasvet®

Göksu Mahallesi Gazi Bulvarı 92. Sokak No: 465/9 Kepez/ANTALYA

T:+90 242 323 94 91 F: +90 242 323 84 01

hasvet@hasvet.com.tr

www.hasvet.com.tr